



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Laboratorní vybavení pro patologicko-anatomické oddělení
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 7. září 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce

Dotaz č. 1:

Zadavatel zveřejnil seznam aktuálně používaných primárních protilátek. Žadatel žádá o sdělení, respektive upřesnění, zda se jedná o konečný seznam, případně o doplnění, které protilátky plánuje dále zavést.

Odpověď:

Zadavatel předpokládá, že spektrum používaných protilátek není konečné. Odvíjí se to však od personální situace na oddělení. Blíže nelze aktuálně specifikovat.

Dotaz č. 2:

Zadavatel uvedl roční počet vyšetření. Žadatel žádá rovněž o doplnění průměrného počtu vyšetření za den.

Odpověď:

Průměrná denní produkce připravených skel je 30-80.

Dotaz č.3:

Přikrajovací zařízení s dokumentačním zařízením a příslušenstvím pro patologicko-anatomické oddělení pardubické nemocnice

30x optický zoom a autofocus - zoom systému je generován elektronickým posuvem aparátu na rameni, dotekovým ovladačem s pamětí na 3 pozice. Zorné pole fotoaparátu činí 35° a maximální poměr zvětšení je 1:1, dokáže tak zachytit předměty větší než plocha A4 a zároveň detaily velikosti cca 25mm na celou plochu snímáče aparátu v nejvyšší kvalitě. Bude akceptováno takové řešení?

Odpověď: Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Držák kamery pro foto stojan - držák kamery integrován přímo do přikrajovacího pracoviště, bude akceptováno toto řešení? Odpověď: Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

V případě, že bude akceptováno plně integrované řešení držáku pro záznamové zařízení (viz dotaz č.4), kde rameno navíc lze elektronicky zcela zasunout do horní pozice a nenarušuje tak pracovní prostor, můžeme oba body považovat za akceptované?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č.6:

Generování reportů ve formátu RTF pro MS, uspořádaných dle přehledné tabulky. Bude akceptováno toto řešení? Odpověď: Ne, zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení dodavatele z důvodu standardizace reportů používaných v laboratoři ve formátu RTF pro MS WORD (Zadavatel nezná nabízenou konkrétní formu v excelu) Bude akceptováno řešení ve formátu DOC pro MS Word + XLS pro MS EXCEL, dle přiložených vzorových souborů a screenshotů?


DOC pro MS Word



MUDr. Alexandr Novotný
Laboratoř A87

Jméno:
Příjmení:
Datum měření:
Podmínky měření:
Poznámka:

Snímek č. 1

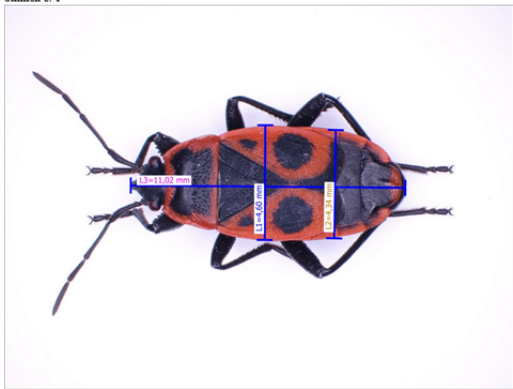

Typ objektu	Velikost	C. měření	Hodnota	Jednotky	Popis
Uševka	Délka	1	4.54	mm	
Uševka	Délka	2	4.54	mm	
Uševka	Délka	3	11.02	mm	

export_do_MS_Excel													
Soubor Domů Vložení Rozložení stránky Vzorce Data Revize Zobrazení Nápoředa Řekněte mi, co chcete udělat													
Vložit Vložit Kopírovat Kopírovat formát Schránka Písmo Zarovnání Číslo Podmíněné formátování													
A1 Délka													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Délka												
2	Typ objektu	Veličina	Č. měření	Hodnota	Jednotky	Popis	Statistiky						
3	Úsečka	Délka	1	4,60	mm	Veličina	Délka						
4	Úsečka	Délka	2	4,34	mm	Počet měření	3						
5	Úsečka	Délka	3	11,02	mm	Minimální hodnota	4,34	mm					
6						Maximální hodnota	11,02	mm					
7						Střední hodnota	6,653	mm					
8						Směrodatná odchylka	3,090	mm					
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č.8:

Položka veřejné zakázky: Tiskárna kazet s příslušenstvím pro Patologicko-anatomické oddělení Pardubické nemocnice - 1 ks

Rozměry s zařízením 200x400x500mm: Bude akceptováno zařízení s rozměry 53x47x46 cm? Rozměr 20 cm nelze splnit v případě požadavku na automatické podávání kazet ze všech zásobníků (viz odpověď dotazu č. 2, bod b), kdy toto řešení je o něco širší. Upozorňujeme, že tento parametr šířky 200mm dokáže splnit také pouze jediný dodavatel na trhu a tento parametr je tak značně znevýhodňující pro ostatní účastníky.

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ
NABÍDEK DO 12. 10. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková