



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Anesteziologické přístroje, část 2

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 10. 5. 2022


Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 2 splnění parametru:

„Elektronicky řízený ventilátor s vizuální kontrolou netěsnosti okruhu v každém dechovém cyklu (měch ve válci v zorném poli obsluhy)“

Účastník by rád nabídnul anesteziologický přístroj s elektronicky řízeným ventilátorem s pneumatickým pohonem ventilátoru, který ale nemá systém stojatého měchu ve válci. Nabízíme alternativní řešení, kde je stojací měch ve válci plně nahrazený tzv. Objemovým výměníkem, kde vizuální kontrola netěsností probíhá on-line v každém dechovém cyklu na tzv. systémovém, barevném displeji o velikosti 8,4". Případná netěsnost je indikovaná graficky na tomto displeji.

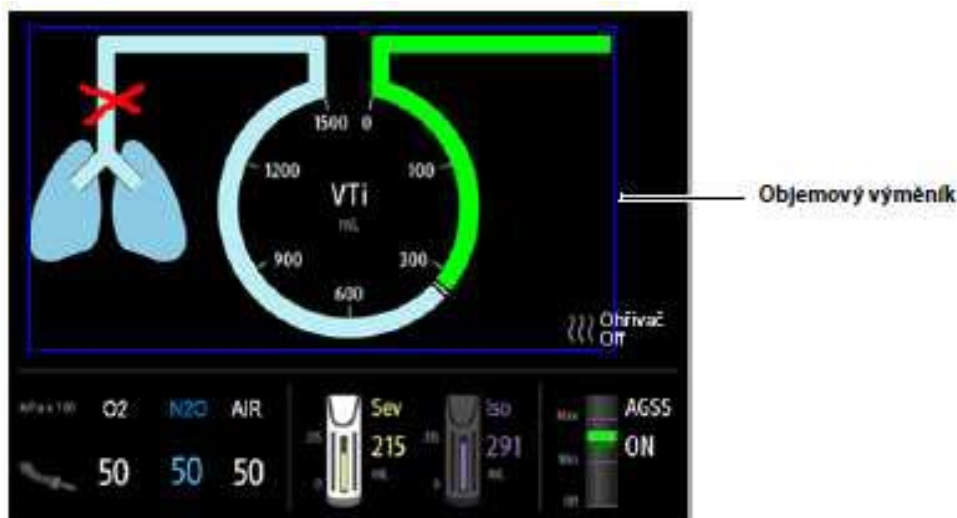



Účastník má za to, že tímto alternativním technickým řešením splní v plném rozsahu požadavek zadavatele na vizuální kontrolu netěsností. Nabízené alternativní řešení nemá negativní vliv na medicínský účel pořizovaného zdravotnického prostředku.

Bude zadavatel akceptovat nabídku s vizuální kontrolou netěsností, kterou popisujeme výše?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 2 splnění parametru:

„Pro rychlou adaptaci na změnu koncentrace plynů, autoklávovatelná nádoba absorbéru s kapacitou náplně do 1 kg, snadno a rychle vyměnitelná bez použití nástroje“

Účastník by rád nabídnul anesteziologický přístroj s kapacitou náplně absorbéru 1,5 kg.

Zadavatel neuvádí časový údaj, o jak rychlou adaptaci na změnu koncentrace plynů má jít při použití náplně s kapacitou do 1 kg. Můžeme se jen domnívat, že s náplní do 1 kg by mohla být adaptace o „něco málo“ rychlejší než s náplní 1,5 kg, kde je adaptace na změnu koncentrace plynů také rychlá. Na rychlost adaptace na změnu koncentrace plynů má také významný vliv použití druhu absorbentu. Účastník má za to, že požadavek zadavatele na „rychlou adaptaci“, je relativní pojem, není možné ho jednoznačně přiřadit k absorbéru s kapacitou náplně do 1 kg a že ke stejné rychlé adaptaci na změnu koncentrace plynů může dojít také při použití absorbéru s kapacitou 1,5 kg. Takto definovaný požadavek zadavatelem je neopodstatněný a mohl by v soutěži zvyhodňovat konkrétního dodavatele.

Bude zadavatel akceptovat nabídku s nádobou absorbéru s kapacitou náplně max. do 1,5 kg, která garantuje rychlou adaptaci na změnu koncentrace plynů, a která je snadno a rychle vyměnitelná bez použití nástroje?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 6. 2022 do 11:00 hodin. Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 2 OPRAVA dle VZD 1.docx

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.