



Smlouva č. OR/14/23438

**„Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení -
dodávka lékařské technologie a drobné lékařské technologie, část 3**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Oldřich Kopecký,
Ing. Jan Kosla, Julius Koudelka
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
č.ú. 220764424/0300

2. Dodavatel: **HOSPIMED, spol. s r.o. / sídlo: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3**
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 480
IČ: 00676853
DIČ: CZ00676853
zastoupený: Ing. Radimem Celeckým, Ing. Věrou Svobodovou,
Janou Doubravovou
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radim Celecký
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu 5274852/0800 (doplní uchazeč, je-li
uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli
předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu
podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na
dodávky s názvem „Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického
oddělení - dodávka lékařské technologie a drobné lékařské technologie“ zadávané dle
zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a v
souladu s platnou Příručkou pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a
dodavatelem jako uchazečem vybraným k plnění k části 3 této veřejné zakázky, evidenční
číslo ve Věstníku veřejných zakázek 483393.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží - zdravotnických prostředků přístrojového charakteru - zdravotnických technologií a jejich příslušenství (dále jen „zboží“) tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Dodavatel prohlašuje, že

a) kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům (č. 154/2004 Sb., č. 336/2004 Sb., č. 453/2004 Sb. – dále jen „nařízení vlády“), harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;

b) zboží je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, zejména, že u zboží byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zboží, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, dodavatel je povinen předložit objednateli kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. V případě zboží, které dosud nebylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády (§ 17 odst. 4 n. v. č. 336/2004 Sb., v platném znění), je dodavatel povinen předložit jako doklad o vhodnosti zboží pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití). Dodavatel předloží objednateli rovněž i kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se ke zboží.

3. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit instalaci, příp. montáž zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny. Dodavatel se rovněž zavazuje k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.

Služby spočívající v uvedení pořízovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro jeho obsluhu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, není-li níže výslovně uvedeno jinak.

4. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit poskytování bezplatného záručního servisu po celou dobu záruční doby za podmínek uvedených v této smlouvě.

5. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit jeho periodické prohlídky, pravidelné periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků (PBTk) a validace po dobu trvání záruky na jakost zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce.

6. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit rovněž:

- dopravu zboží na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
- předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
- předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, příslušné dokumentace dle zákona 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a příp. dokladů dle zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné,
- předání certifikátu CE,
- zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb ,III),
- protokolární předání zboží do provozu objednateli,
- předání protokolu o zaškolení obsluhy,
- odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v platném znění.

7. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III., této smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

II.

Cena

1. Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele (clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis, pravidelné periodické bezpečnostně-technické kontroly zdravotnických prostředků dle zák. č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, apod.), a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.

Cena celkem bez DPH 1 894 900,00 Kč
DPH 21 % 70 854,00 Kč, DPH 15 % 233 625,00 Kč
cena celkem včetně DPH 2 199 379,00 Kč.

2. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.

Položkové rozdělení ceny je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

III.

Doba plnění, místo plnění a ostatní ujednání

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení odborného personálu do 6 týdnů od oznámení provedeného osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení odborného personálu nejpozději do 28. 11. 2014, a to v případě že oznámení osoby oprávněné jednat za objednatele dle první věty nebude učiněno do 17. 10. 2014.

2. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín instalace a montáže předmětu této smlouvy na místo plnění. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu této smlouvy na místo plnění, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu této smlouvy bez následné smluvní pokuty za prodlení dodavatele.

3. Místem splnění předmětu smlouvy je areál Svitavské nemocnice, a.s. ve Svitavách.

4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání zboží, montáži, instalaci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy. Nedílnou součástí předávacího protokolu jsou veškeré nezbytné doklady pro provoz v ČR. Školené osoby objednatele dosáhnou kvalifikace pro školení dalších pracovníků objednatele. O tom vydá dodavatel prohlášení, ve znění: Účastníci školení obsluhy jsou oprávněni ke školení dalších pracovníků ve Svitavské nemocnici, a.s.

5. Osoby, které převezmou zboží za objednatele a podepší předávací protokol, budou oznámeny dodavateli v dostatečném předstihu před dodáním předmětu smlouvy. Převezetí zboží jinými osobami, než těmi uvedenými v oznámení, nebude považováno za řádné.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.

2. Splatnost faktury je do 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je dodavatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu dle čl. III. odst. 4 smlouvy.

V. Sankce

1. V případě porušení povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách uvedených na jiných místech smlouvy, následující:

1. Bude-li dodavatel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla dle čl. III. smlouvy, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny uvedené v článku II. smlouvy.
2. Smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny reklamovaného zboží za každý den prodlení může být uplatňována rovněž za:
 - a) pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad (do 48 hodin v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku) v záruční době dle čl. VI. odst. 8 nebo
 - b) pokud bude odstranění závady trvat déle než 72 hodin.
2. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy dodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.
3. Zaplacením smluvní pokuty dodavatelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním dodavatele. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

VI. Záruka, záruční servis

1. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.
2. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží činí 60 měsíců a běží ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po převzetí předmětu plnění a podepsání předávacího protokolu.
5. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad po celou dobu záruční lhůty.
6. Dodavatel je povinen zajistit bezplatný záruční servis sám nebo prostřednictvím autorizované servisní organizace:

Název	HOSPIMED, spol. s r.o.
Sídlo	Maletšická 2251/51, 130 00 Praha 3
Zapsána	v OR, vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 480
Zastoupená	Ing. Radimem Celeckým, Ing. Věrou Svobodovou, Janou Doubravovou

IČ	00676853
DIČ	CZ00676853
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s. 5274852/0800
Telefon	225 001 566
E-mail	jana.simackova@hospimed.cz
Odpovědné osoby	Jana Šimáčková

V případě, že záruční servis neprovádí dodavatel sám, předloží do 3 pracovních dnů ode dne, kdy o to byl objednatel požádán, buď písemné potvrzení autorizované servisní organizace, nebo kopii smlouvy s touto servisní organizací, a prohlášení této servisní organizace o splnění podmínek dle odstavce 7.

7. Dodavatel čestně prohlašuje, že výše uvedená autorizovaná servisní organizace:
- o ve formuláři, který předložila ke splnění ohlašovací povinnosti dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích (provedení povinné registrace) uvedla, že je registrována jako servisní organizace,
 - o instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádí osoby uvedené v § 22 odst. 2 zákona č. 123/2000 Sb. s tím, že:

Počet těchto osob je:	2
Jejich vybavení:	potřebné k vykonávání autorizovaného servisu a provádění PBTk.

8. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního dne po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku po nahlášení závady.

9. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle, než je výše uvedeno, nebo bylo dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží stejné úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během záruční doby se dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky, technické kontroly a validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.

VII. Odstoupení od smlouvy

K odstoupení od smlouvy může dojít v souladu s ustanovením občanského zákoníku, a to ust. § 2001 a následující.

VIII. Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. Dodavatel se zavazuje k uchování této smlouvy včetně jejích případných dodatků, veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky „Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení – dodávka lékařské technologie a drobné lékařské technologie“ v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR a podmínkami Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Dodavatel se zavazuje, že

umožní neustálou dostupnost výše uvedených dokladů pro účely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícím kontrolu případně audit projektu poskytnout potřebné informace týkající se dodavatelských činností.

2. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV) s názvem: „Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení“ a registračním číslem projektu CZ.1.13/2.2.00/28.01151. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.

3. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod verze č. 17.0 ze dne 30. září 2013 včetně příloh a dalších dokumentů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dostupných na www.rada-severovychod.cz. V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.


IX.


Obecná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
3. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným a číslovaným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
5. Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele uvedenou v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zveřejnit tuto smlouvu na jeho profilu, povinnost dodavatele poskytnout objednateli seznam svých subdodavatelů, kterým uhradil více než 10% za plnění subdodávky, a povinnost dodavatele předložit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, a to do 60 dnů od splnění smlouvy.
6. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.
7. Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž dodavatel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
8. Projednáno na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 11. 2014 a schváleno usnesením R/1507/14.

Příloha smlouvy č. 1 - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen

V Pardubicích dne - 3 -12- 2014


.....
za Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

V Praze dne 26.11.2014

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
..... Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
za dodavatele HOSPIMED, spol. s r.o.
paní Jana Doubravová

Příloha smlouvy č. 1 - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen


TECHNICKÝ LIST ČÁST 3

T-6010

1x Lůžko PLL-N85-0 - nepojízdné s úpravou pro kotvení k podlaze

- Lůžko v souladu s normou ČSN EN 60601-2-52
- Nohy pevné nepojízdné, nosnost 200 kg
- Čtyřdílná ložná plocha, výška 50 cm
- Zádový díl, stehenní díl - polohování pístitnice
- Lýtkový díl - polohování hřeben
- Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm
- 2x univerzální držák příslušenství - hlavová část
- Typ ložné plochy - kovové lamely
- Šířka ložné plochy 85 cm
- Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová
- Čela kovová lakovaná s výplní HPL, typ C, zvýšená, neodnímatelná
- Postranice sklopné kovové lakované zvýšené (sada 2 ks)
- Ložná plocha 200 x 85 cm, výška 50 cm
- RAL 9016 bílá, HPL dle vzorníku

Ilustrativní vyobrazení:

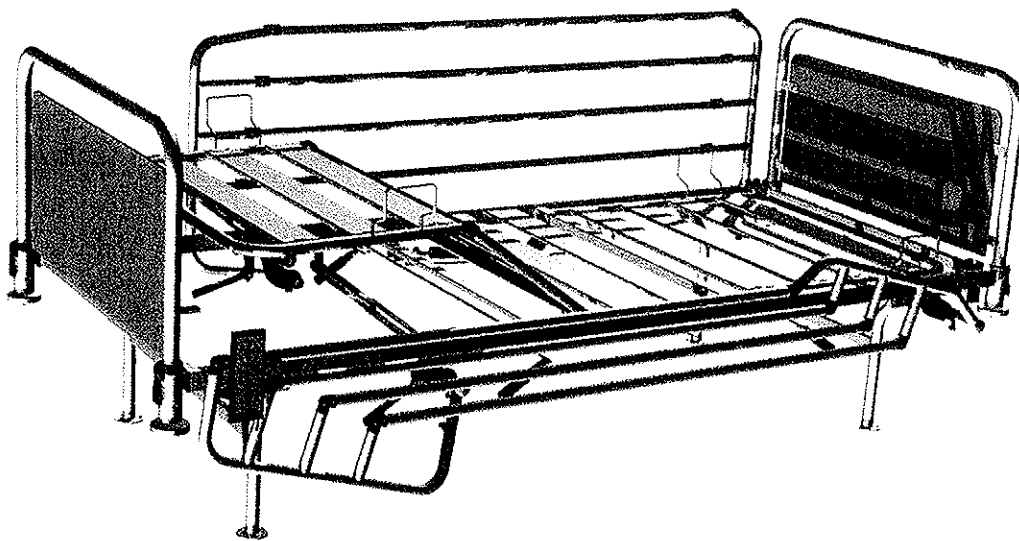

1x Pasivní matrace LUX FLEX

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů s nízkým a středním rizikem vzniku dekubitů (I. - II. stupně)

Jádro ze studené pěny, podélný a příčný prořez, 3 zóny

Boky vyztuženy PUR pěnou vysoké objemové hmotnosti

Vhodná pro polohovatelná lůžka


Potah SAFR, šitý, zip ze 2 stran s okeničkou

Potah SAFR zaručuje pružnost ve všech čtyřech směrech, paropropustnost, omyvatelnost, lze jej ošetřovat běžnými desinfekčními prostředky a je odolný proti účinkům moči, krve apod. Je antialergický a antibakteriální. Potah má sníženou hořlavost. Lze jej prát do teploty 95°C.

Rozměr matrace 200 x 85 cm

Výška matrace 20 cm

Nosnost 200 kg

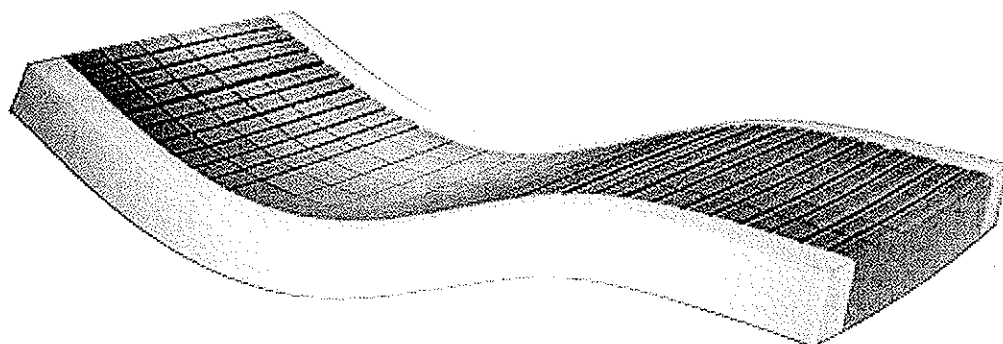


T-6015

30x Lůžko PLL-N85-0 - pojízdné

Lůžko v souladu s normou ČSN EN 60601-2-52
Nohy pro montáž koleček, nosnost 200 kg
Kolečka 125 mm - kov, 3x brzda, 1x směrová aretace
Čtyřdílná ložná plocha, výška 50 cm
Zádový díl, stehenní díl - polohování pístitnice
Lýtkový díl - polohování hřeben
Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm
2x univerzální držák příslušenství - hlavová část"
Typ ložné plochy - kovové lamely
Šířka ložné plochy 85 cm
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) – plastová
Čela kovová lakovaná s výplní HPL, typ C, zvýšená, neodnímatelná
Postranice sklopné kovové lakované zvýšené (sada 2 ks)
Ložná plocha 200 x 85 cm, výška 50 cm
RAL 9016 bílá, HPL dle vzorníku

Ilustrativní vyobrazení:

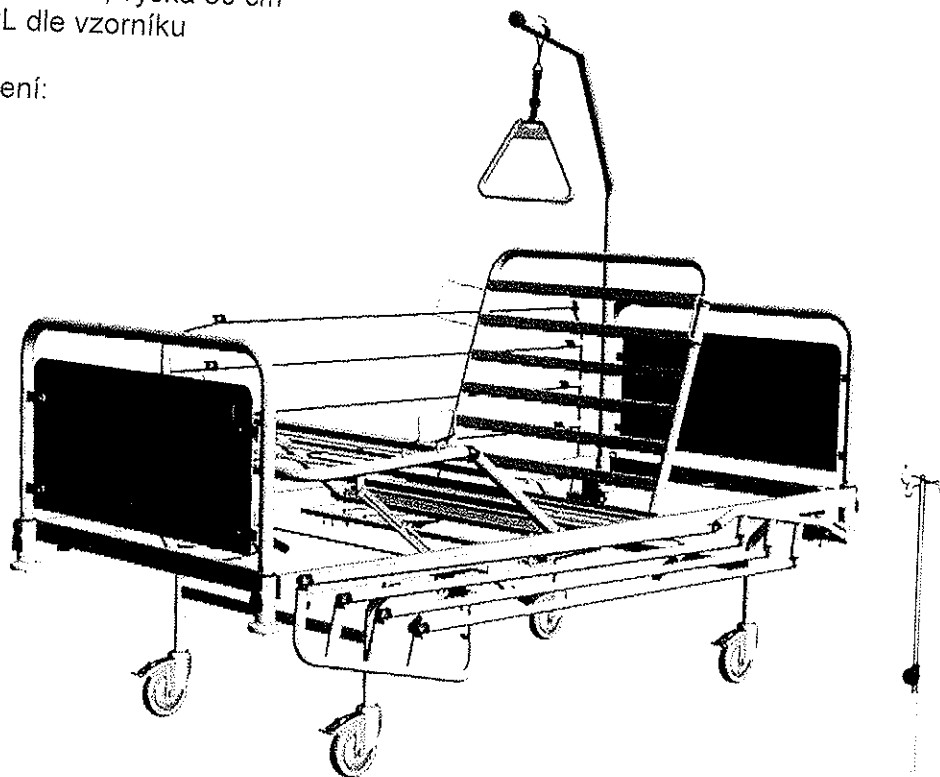

- 10 x **Kovová lakovaná hrazda** (vyobrazeno na lůžku)
Plastová hrazdička s popruhem (vyobrazeno na lůžku)
Infuzní stojan komaxit + chrom

30x Pasivní matrace LUX FLEX

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů s nízkým a středním rizikem vzniku dekubitů (I. - II. stupně)

Jádro ze studené pěny, podélný a příčný prořez, 3 zóny

Boky vyztuženy PUR pěnou vysoké objemové hmotnosti

Vhodná pro polohovatelná lůžka


Potah SAFR, šitý, zip ze 2 stran s okeničkou

Potah SAFR zaručuje pružnost ve všech čtyřech směrech, paropropustnost, omyvatelnost, lze jej ošetřovat běžnými desinfekčními prostředky a je odolný proti účinkům moči, krve apod. Je antialergický a antibakteriální. Potah má sníženou hořlavost. Lze jej prát do teploty 95°C.

Rozměr matrace 200 x 85 cm

Výška matrace 14 cm

Nosnost 140 kg

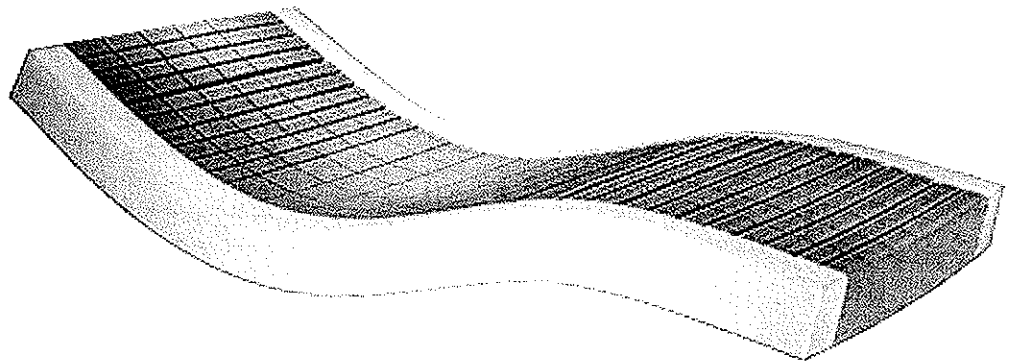

T-6017

25x Lůžko PLH-N85-0

Lůžko v souladu s normou ČSN EN 60601-2-52

Podvozek - nosnost 220 kg, zdvih ložné plochy 38,5-80 cm

Kolečka 125 mm - kov, 3x brzda, 1x směrová aretace

Čtyřdílná ložná plocha

Zdvih ložné plochy - polohování hydraulické

Zádový díl, stehenní díl - polohování pístnice

Lýtkový díl - polohování hřeben

Autoregrese - zádový díl, stehenní díl

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

2x univerzální držák příslušenství - hlavová část

Typ ložné plochy - kovové lamely

Šířka ložné plochy 85 cm

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová

Čela kovová lakovaná s výplní HPL, typ D, zvýšená, neodnímatelná

Postranice sklopné kovové lakované odnímatelné zvýšené (sada 2 ks)

Ložná plocha 200 x 85 cm, výška 38,5 – 80 cm

RAL 9016 bílá, HPL dle vzorníku

Ilustrativní vyobrazení:



- 12x Kovová lakovaná hrazda (vyobrazeno na lůžku)
- Plastová hrazdička s popruhem (vyobrazeno na lůžku)
- Infuzní stojan komaxit + chrom

25x Pasivní matrace EUCATHERM

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů s vysokým rizikem vzniku dekubitů (III. stupně)
Jádro ze studené pěny a paměťové pěny, 3 zóny

Vhodná pro polohovatelná lůžka

Paměťová pěna po celé ploše pro optimální rozložení váhy těla a oporu co největší plochy tkáně


Potah SAFR, šitý, zip ze 2 stran s okeničkou

Potah SAFR zaručuje pružnost ve všech čtyřech směrech, paropropustnost, omyvatelnost, lze jej ošetřovat běžnými desinfekčními prostředky a je odolný proti účinkům moči, krve apod. Je antialergický a antibakteriální. Potah má sníženou hořlavost. Lze jej prát do teploty 95°C.

Rozměr matrace 200 x 85 cm

Výška matrace 14 cm

Nosnost 140 kg

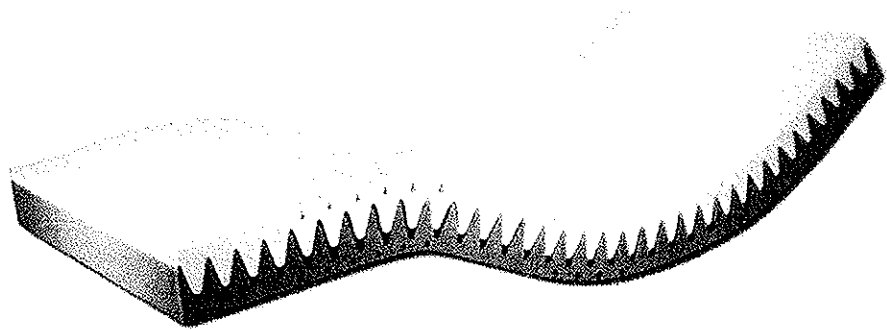

hčanský zakur...

HOSPIMED®
generální dodávky

T-6302

6x Vyšetřovací lehátko ELEVA H

- Robustní konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou nezávadným nástřikem
- Ložná plocha výškově stavitelná pomocí hydraulického motoru
- Plastový kryt podvozku
- Všechny funkce lehátka jsou naprosto nezávislé na zdroji elektrické energie
- Dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí
- Čalouněno zdravotnickou koženkou (voděodolná, paropropustná, umyvateľná, snížená hořlavost, dezinfikovatelná)
- Polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice
- Při maximálním zdvihu ložné plochy je zajištěna velmi dobrá stabilita
- Lehátko je vybaveno držákem role hygienického papíru – možnost oboustranného připevnění
- Pojezdová kola kovová o průměru 150 mm s centrální brzdou a aretací
- Nárazová kolečka
- Sklopné nerezové zábrany v délce delší než ¾ délky ložné plochy
- Držák infuzního stojanu
- Ložná plocha 75 x 210 cm
- Výška 55 – 95 cm
- Zádový díl 0° - 66°
- Nosnost 170 kg
- RAL 9016 bílá, koženka dle vzorníku




HOSPIMED®
generální dodávky

T-6605

2x Váha s výškoměrem TH 200

- Digitální váha s výškoměrem
- Kalibrovatelná
- Možnost připojení pomocí sériového kanálu na tiskárnu, nebo PC
- Funkce TARA, nulování, výpočet BMI
- Přepínání mezi výškou a hmotností pomocí tlačítka
- Snadná obsluha
- Výrazný displej = hodnota je vidět čitelně z dálky
- Na vážící ploše protiskluzová guma proti uklouznutí
- Výškoměr od 110 cm do 210 cm po 0,5 cm
- Samolepa se stupnicí 70 - 110 cm
- Typové schválení ES typu (úředně ověřená váha)
- Váživost max.: 200 kg
- Dílek (e=d): 100 g, počet dílků: 2000
- Rozměr vážící plochy 33 x 33 cm

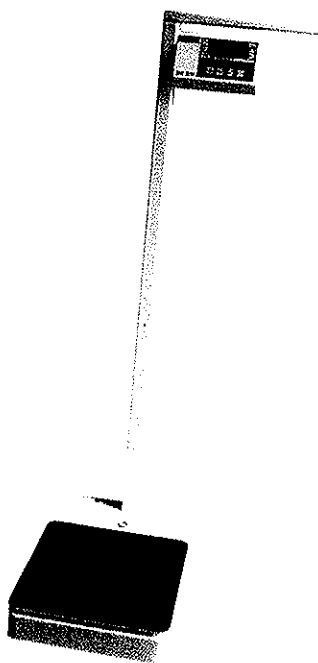


...nizační lékař...
...ranský zakou...
HOSPIMED®
generální dodávky

T-6712

2x Sprchovací lehátko LS-2100

Všechny funkce jsou naprosto nezávislé na zdroji elektrické energie
Velmi snadná a jednoduchá obsluha sprchovacího lehátka
Výškově stavitelné lehátko pomocí hydraulického motoru v rozsahu 54 – 94 cm
Celonerezová konstrukce
Jednodílná ložná plocha se slonem k odtokovému ústí
Mírný sklon ložné plochy k odtokovému ústí
Vana lehátka z jednodílné ložné plochy s odtokovými drážkami, dezinfikovatelná
Flexibilní odtoková hadice v nožní části lehátka, uzávěr odtokové části
Plastový kryt podvozku
Sklopné nerezové zábrany po obvodu ložné plochy s ochranou před nechtěným spuštěním
Plastová kolečka o průměru min. 125 mm s plastovým krytím a centrální brzdou
Součástí lehátka polštářek, který usnadňuje celý proces osobní hygieny
Vnitřní rozměr vany: 60 x 195 cm
Nosnost 170 kg
RAL 9016 bílá

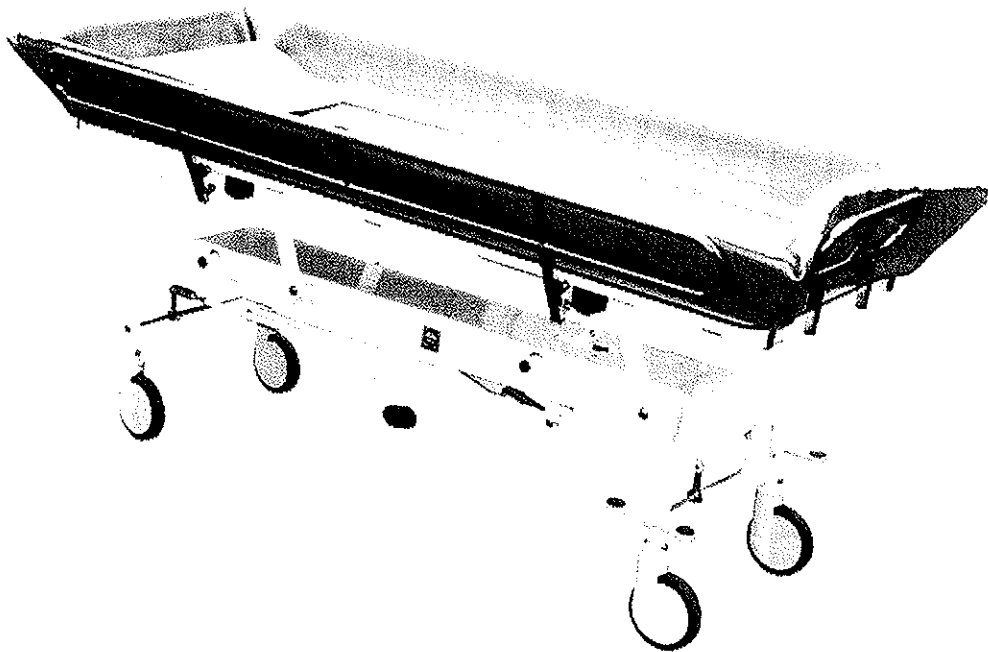

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Tuto nabídku Vám předkládá divize **KOMPLETACE®**

LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro část 3

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem	DPH ve výši 15%	Cena v Kč včetně DPH celkem
T-6010	<u>PS 201 - LÉKÁRSKÁ TECHNOLOGIE A DROBNÁ TECHNOLOGIE, SO 01 A SO 02</u> Lůžko 2-dílné, mechanické, kotvené do podlahy	Lůžko musí splnit normu ČSN EN 60601-2-52, čtyřdílná ložná plocha, čistitelná a dezinfikovatelná, bez odnímatelných dílů z kovových lamel. Čela kovová, lakovaná s výplní HPL, neodnímatelná. Postranice minimálně 3/4 sklopné, kovové. Žádový a stehenní díl polohovatelný pomocí plynové pístitnice, lýtkový díl polohování hřeben. Integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 150 mm, v hlavové části univerzální držák na příslušenství (infuzní stojan, hrazda). Nosnost lůžka minimálně 200 kg, pevná výška ložné plochy v 50 cm (tolerance +/- 5 cm), šířka ložné plochy 85 cm (tolerance +/- 2 cm), délka standardní ložné plochy 200 cm, nohy lůžka pro montáž-kotvení k podlaze. Matrace antidekubitní pasivní pro střední riziko vzniku dekubitů, paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; dezinfikovatelný, pratelný na 95 °C, vyměnitelný potah matrace se zipem a s ochranou proti zatékání tekutin, rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, nosnost do 200 kg, vhodná do polohovatelného lůžka. Možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním / materiálovým řešením vybavení dle PD interiéru	PLL-N85-0	1	ks	20 450,-	20 450,-	3 068,-	23 518,-
T-6015	Lůžko 4-dílné, mechanické, pojízdné, s dřevěným obložním	Lůžko musí splnit normu ČSN EN 60601-2-52, čtyřdílná ložná plocha, čistitelná a dezinfikovatelná, bez odnímatelných dílů z kovových lamel. Čela kovová, lakovaná s výplní HPL, neodnímatelná. Postranice minimálně 3/4 sklopné, kovové. Žádový a stehenní díl polohovatelný pomocí plynové pístitnice, lýtkový díl polohování hřeben. Integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 150 mm, v hlavové části univerzální držák na příslušenství (infuzní stojan, hrazda). Nosnost lůžka minimálně 200 kg, pevná výška ložné plochy v 50 cm (tolerance +/- 5 cm), šířka ložné plochy 85 cm (tolerance +/- 2 cm), délka standardní ložné plochy 200 cm, kolečka minimálně o průměru 125 mm, kov, 3 x brzda, 1 x směrová aretace. Matrace antidekubitní pasivní pro nízké riziko vzniku dekubitů, paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; dezinfikovatelný, pratelný na 95 °C, vyměnitelný potah matrace s se zipem s ochranou proti zatékání tekutin, rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, nosnost matrace do 140 kg, 3-zónová, vhodná do polohovatelného lůžka. Možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním / materiálovým řešením vybavení dle PD interiéru. K 10 lůžkům (1/3) příslušenství do univerzálního držáku (hrazda, infuzní stojan).	PLL-N85-0	30	ks	20 660,-	619 800,-	92 970,-	712 770,-
T-6017	Lůžko 4-dílné, mechanické, pojízdné		PLH-N85-0, pojízdné	25	ks	36 690,-	917 250,-	137 588,-	1 054 838,-

	<p>Lužko musí splnit normu ČSN EN 60601-2-52, lužko hydraulicky polohovatelné v krajních polohách 40 - 80 cm výšky (tolerance +/- 5 cm), čtyřdílná ložná plocha, čistitelná a dezinfikovatelná, bez odnímatelných dílů z kovových lamel. Čela kovová, lakovaná s výplní HPL, neodnímatelná. Postranice minimálně 3/4 sklopné, kovové. Zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí plynové pistnice, lýtkový díl polohování hřeben. Integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 150 mm, v hlavové části univerzální držák na příslušenství (infuzní stojan, hrazda). Nosnost lužka minimálně 200 kg, šířka ložné plochy 85 cm (tolerance +/- 2 cm), délka standardní ložné plochy 200 cm, kolečka minimálně o průměru 125 mm, kov, 3 x brzda, 1 x směrová aretace. Matrace antidekubitní pasivní pro vysoké riziko vzniku dekubitu, paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; dezinfikovatelný, prateľný na 95 °C, vyměnitelný potah matrace s se zipem s ochranou proti zatékání tekutin, rozměr matrace dle ložné plochy lužka, nosnost do 140 kg, 3-zónová, vhodná do polohovatelného lužka. Možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním / materiálovým řešením vybavení dle PD interiéru. K 12 kusům lužkům (50 %) příslušenství do univerzálního držáku (hrazda, infuzní stojan).</p>						
Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky	Celkem	bez DPH	1 557 500,-	Celkem včetně DPH	1 791 125,-
T-6302		Typové (modelové) označení položky	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem	DPH ve výši 21%	Cena v Kč včetně DPH celkem
-6605	Lehátko vyšetřovací 2-dílné s pevnou výškou, držák papírové role	Eleva H Pojízdě vyšetřovací lehátko, výškově hydraulicky polohovatelné v rozmezí 50-95 cm (tolerance +/- 5 cm), s nastavitelnou dvoudílnou ložnou plochou, polohovatelný podhlavník, se sklopnými postranicemi min. 3/4, s centrální brzdou a aretací, kolečka o průměru min. 150 mm, s nosností min. 170 kg a s úchytem pro přídavnou část (infuzní stojan a držák role hygienického papíru). Kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem / nerezové; vrchní část lehátka čalouněná s voděodolným, paropropustným, umyvatelem povrchem se sníženou hořlavostí, dezinfikovatelné, možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce; možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním / materiálovým řešením vybavení dle PD interiéru. Váha osobní vč. výškoměru	Ks	28 850,-	173 100,-	36 351,-	209 451,-
-6712	Lůžko sprchové vč. polstrované vany a odpadní hadice	Digitální váha; čitelný displej na stojanu; funkce ZAPNUTÍ - TARA - VYPNUTÍ; horní mez váživosti minimálně 200 kg, s možností metrologického ověření	Ks	20 310,-	40 620,-	8 530,-	49 150,-
	Lůžko sprchové vč. polstrované vany a odpadní hadice	Výškově stavitelné pomocí hydrauliky, výška v rozsahu 50-90 cm (tolerance +/- 5 cm), celonerezová konstrukce; jednodílná ložná plocha se sklonek o odtokové části. Vana lehátka jednodílná s odtokovou drážkou, dezinfikovatelná, flexibilní odtoková hadice v nožní části lužka, součástí lehátka podhlavní polštářek a uzávěr odtokové části. Plastový kryt podvozku, sklopné nerezové zábrany s pojistkou proti nechtěnému spuštění. 4 otočná kolečka o průměru minimálně 125 mm, s plastovým krytím a centrální brzdou. Nosnost minimálně 170 kg, vnitřní rozměr vany šířka 60 x délka 195 cm (tolerance +/- 5 cm).	Ks	61 840,-	123 680,-	25 973,-	149 653,-
		Celkem	Celkem	bez DPH	337 400,-	Celkem včetně DPH	408 254,-

Celkem nabídka 3. část

bez DPH

1 999 900

Celkem
včetně DPH

2 199 379