



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Přístroj pro chlazení a ohřev pacienta

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 1. 9. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k Veřejné zakázce: Přístroj pro chlazení a ohřev pacienta, konkrétně k příloze č. 2 zadávací dokumentace - technické podmínky:

- 1ks matrace
- 1ks pokrývka hlavy

V současné době existují různé možnosti teplotního managementu pacienta, které splňují požadovaný medicínský účel a použití, přičemž v současnosti se preferuje celotělové řešení chlazení/ohřevu, a to z důvodů vyšší účinnosti a také vyšší bezpečnosti pacienta (odpadá nutnost extrémně nízkých/vysokých teplot chladicího média).

Dotaz č.1: Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj pro chlazení a ohřev pacienta splňující zamýšlený medicínský účel a použití, na bázi technologie celotělových wrapů pokrývajících větší povrch pacienta, avšak bez možnosti použití matrace a pokrývky hlavy?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat celotělové řešení chlazení a ohřevu pacienta pomocí technologie celotělové podložky (wrapu), která bude určena pro opakované použití



Dotaz č. 2

- 1ks jícnový chladící katetr

Různí výrobci nabízí různé technologie pro dosažení stejného medicínského účelu a použití. V současnosti jsou trendem neinvazivní způsoby chlazení a ohřevu pacienta přinášející výhody jak pro pacienta (snížení zdravotních rizik vyplývajících z invazivní technologie) tak i pro zdravotnických personál (snazší obsluha).

Dotaz č. 2: Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj pro chlazení a ohřev pacienta bez možnosti použití jícnového chladícího katetru?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče

Dotaz č. 3

Žádost o doplnění zadávací dokumentace

Vážení,

Dovolujeme si Vám touto cestou nabídnout obdobné řešení jako možnost, kterou uvádíte v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.


Nabízíme obdobnou možnost chlazení a ohřevu pacienta – Systém regulace teploty Arctic Sun 5000.

Možnost regulovat ohřev pacienta od 0,01 až do 0,5 stupně za hodinu s ohledem na doporučení. Koeficient přenosu tepla u Arctic Sunu se rovná přenosu tepla ve vodě...a je 2,5krát větší než u běžné vodní deky. Toto zohledňují 2 klíčové prvky: intimní kontakt hydrogelové podložky s pokožkou pacienta a vysoká tepelná vodivost samotného hydrogelu. Arctic Sun je přístroj určený k řízené termoregulaci pacienta s možností výběru léčby formou hypotermie či normotermie. Teplota pacienta je měřena každou vteřinu a tak upravuje teplotu vody každé 2 minuty tzn. je 15 x rychlejší než průměrná deka.

ArcticGel™Pad podložky - patentovaná 3-vrstvá konstrukce – viz. obr:

- První vnější izolační vrstva řídí tok řadou kanálů a důlků
- Druhá vrstva/tenký film, kde protéká voda
- Třetí adhezivní vrstva v kontaktu s pokožkou z hydrogelu

Podložky ArcticGel jsou radiolucentní a neobsahují latex.

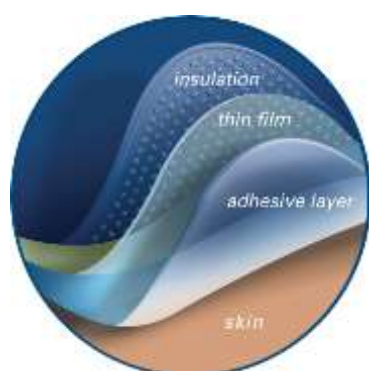



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Námi nabízený přístroj pro řízenou hypotermii je zpětnovazebný a splňuje doporučení odborných společností pro „TTM Targeted Temperature Management“ k použití této metody u pacientů v intenzivní péči. Je určen k monitorování a řízení teploty u dospělých a dětských pacientů všech věkových kategorií.

Jako součástí žádosti přikládáme katalog námi nabízeného přístroje.

Bude zadavatel akceptovat přístroj a podložky pro ohřev a ochlazení pacienta na základě jiné, ale obdobné technologie, než uvádí v zadávací dokumentaci?

Děkujeme Vám tímto za odpověď a vyjádření.

S pozdravem

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat nabízenou jinou technologii, která bude splňovat stanovené technické parametry v příloze č. 2 ZD

Zadavatel upravuje bod II. 2. kupní smlouvy

Termín plnění je nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 10. 2023 do 11:30 hod.

Přílohy:

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh kupní smlouvy OPRAVA DLE VZD 1

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.