

REV. | REV. DATUM | DATE POPIS | DESCRIPTION
00 30.04.2025 První vydání

NÁZEV STAVBY | BUILDING

NPK, a.s. Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu



MÍSTO STAVBY | LOCATION

INVESTOR | INVESTOR

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

HLAVNÍ | HEAD
ARCHITEKT | ARCHITECT
Karlinblok, s.r.o.

Pernerova 659/31A
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz

hlavní architekt
arch. Vladimír Kružík

manažer
mgr. Petr Jíleček

HLAVNÍ | HEAD
PROJEKTANT | DESIGNER
Karlinblok, s.r.o.

Pernerova 659/31A
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz

hlavní inženýr
Ing. Bohumír Stejskal

hlavní inženýr projektu
(zástupce)
Ing. arch. Stanislav Šrot

ZPRACOVATEL ČÁSTI | SUBCONTRACTOR

Pipeline Design s.r.o.

Frýdklantská 1351/15
460 01, Liberec 1

číslo
420 607 972 847

VYPRACOV | DRAWN
AL | BY
Jiří Štajer

..

..

KONTROLOVAL | CHECKED BY

Jiří Štajer

ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESIGNER

Rudolf Svoboda

STUPEŇ DOKUMENTACE | DESIGN STAGE

DOK. PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

ČÁST | SECTION

D1 DOK. STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

OBJEKT (SO, PS) | BUILDING

C OBJEKT C - DIAGNOSTICKÝ A LŮŽKOVÝ PAVILON (NOVOSTAVBA)

DÍL | PART

PROFESNÍ DÍL | PROFESSION PART

110 ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

MPL

DĚLENÍ | DIVISION

ČLENĚNÍ | STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU | DRAWINGS NAME

KOPIE | COPY

Specifikace koncových prvků

00


DATUM | DATE OF ISSUE

MĚŘÍTKO | SCALE

FORMÁT | PAPER SIZE

ČÁST SO / PS DÍL PROF. DÍL DĚLENÍ ČLENĚNÍ Č. VÝKRESU Č. REVIZE
SECTION BUILDING PART PROF. PT. SECTION STRUCT. DRAW. NO. REV. NO.

NÁZEV SOUBORU | FILE NAME

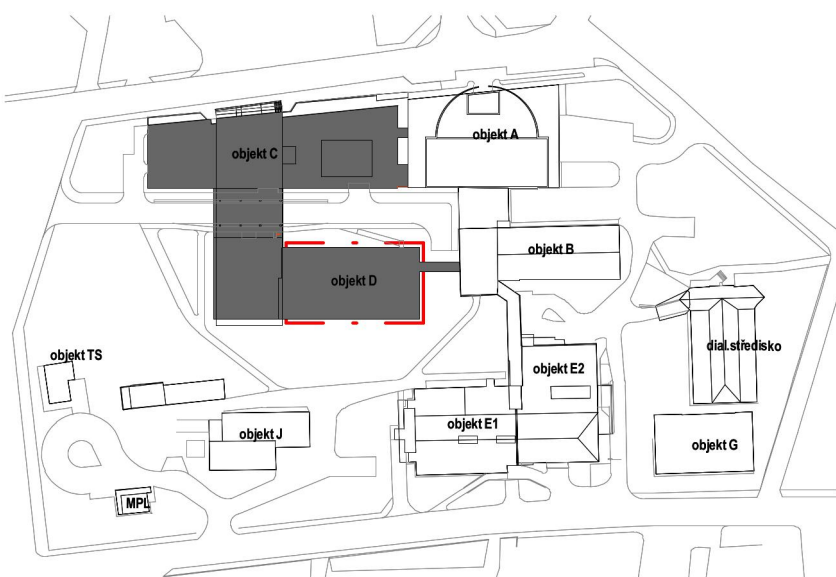

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: Bpv

M 1/50

I I I I I

11m

5m

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_D_110_MPL_007_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail D-KP-03	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Lůžková rampa pro 2 lůžka	
Umístění:	D1.80-2x	
Počet:	2x	
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je rozepsáno pro 1 lůžko)		
Medicínální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bílá)	2x	dle PD silnoproudu
DO (zelená)	2x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	4x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	2x CAT 6 LAN/LAN	
Sestra-pacient:	1x příprava dle projektu slaboproudu.	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
medilišta	délka = 1300 mm	1x na horní hraně rampy
Technické specifikace:		
délka rampy:	2800 mm	
rozteč mezi lůžky:	1400 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

**Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.**

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_D_110_MPL_007_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail D-KP-03	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Lůžková rampa pro 2 lůžka	
Umístění:	D1.36, D1.40, D1.42, D1.44, D1.46,	
Počet:	5x	
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je rozepsáno pro 1 lůžko)		
Medicínální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bílá)	2x	dle PD silnoproudu
DO (zelená)	2x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	4x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	2x CAT 6 LAN/LAN	
Sestra-pacient:	1x příprava dle projektu slaboproudu.	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
medilišta	délka = 1300 mm	1x na horní hraně rampy
Technické specifikace:		
délka rampy:	3550 mm	
rozteč mezi lůžky:	2150 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_D_110_MPL_007_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail D-KP-03	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Lůžková rampa pro 2 lůžka	
Umístění:	D1.38,	
Počet:	1x	
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je rozepsáno pro 1 lůžko)		
Medicinnální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bílá)	2x	dle PD silnoproudu
DO (zelená)	2x	dle PD silnoproudu
VDO-ZIS (oranžová s LED indikací)	1x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	4x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	2x CAT 6 LAN/LAN	
Sestra-pacient:	1x příprava dle projektu slaboproudu.	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
medilišta	délka = 1300 mm	1x na horní hraně rampy
Technické specifikace:		
délka rampy:	3550 mm	
rozteč mezi lůžky:	2150 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

**Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.**

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_D_110_MPL_007_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail D-KP-04	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Lůžková rampa pro 3 lůžka	
Umístění:	D2.30, D3.32, D2.34, D2.36, D2.38, D2.40, D2.42, D2.44, D2.46, D3.30, D3.32, D3.34, D3.36, D3.38, D3.40, D3.42, D3.44, D3.46,	
Počet:	18x	
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je rozepsáno pro 1 lůžko)		
Medicínální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bílá)	2x	dle PD silnoproudu
DO (zelená)	2x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	4x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	2x CAT 6 LAN/LAN	
Sestra-pacient:	1x příprava dle projektu slaboproudu.	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
medilišta	délka = 1300 mm	1x na horní hraně rampy
Technické specifikace:		
délka rampy:	5000 mm	
rozteč mezi lůžky:	1800 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_C_110_MPL_012_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail C-KP-07	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Lůžková rampa pro 3 lůžka	
Umístění:	C4.15-2x, C4.35, C4.40, C4.41, C4.47, C4.67, C4.70	
Počet:	8x	
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je rozepsáno pro 1 lůžko)		
Medicínální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
stlačený vzduch	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bílá)	2x	dle PD silnoproudu
DO (zelená)	2x	dle PD silnoproudu
DO-ZIS (žlutá s LED indikací)	3x	dle PD silnoproudu
VDO-ZIS (oranžová s LED indikací)	1x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	8x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	2x CAT 6 LAN/LAN	
Sestra-pacient:	1x příprava dle projektu slaboproudu.	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
medilišta	délka = 1800 mm	1x na horní hraně rampy
Technické specifikace:		
délka rampy:	5000 mm	
rozteč mezi lůžky:	1800 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.