


Nemocnice Pardubice- Úrazová chirurgie 4.NP-nadstandardní pokoje

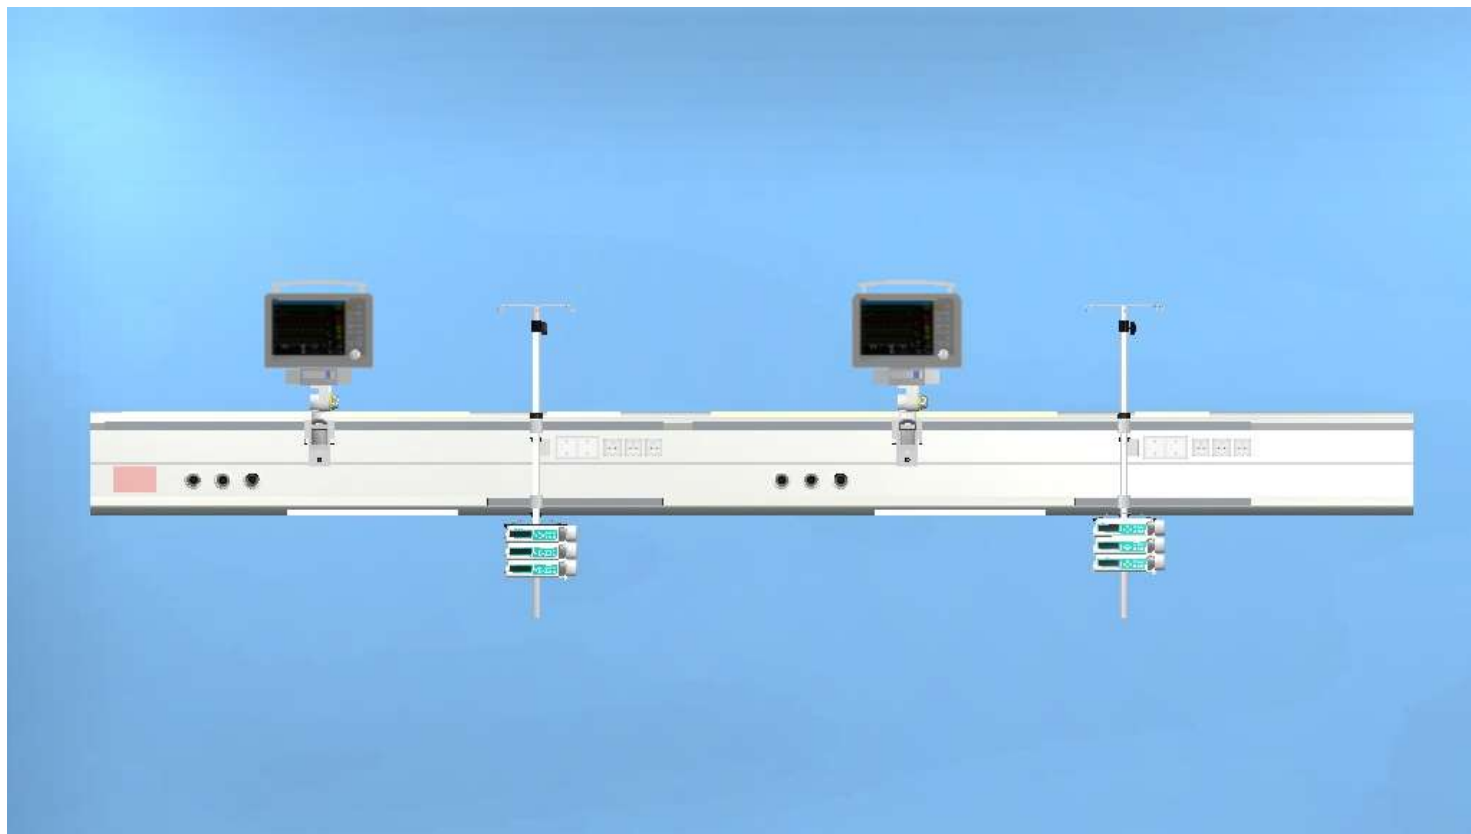

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------|--|----------------|--|-------------------------|
| | | Dvoulůžková rampa délky 4500 mm | | | | | |
| 2ksx2L=4 lůžka | | výbava je pro jedno lůžko | | | | | |
| Délka rampy | | Typ | | Přímé osvětlení | | Nepřímé a noční osvětlení | |
| 2000 mm jedno lůžko | | | | 1x na lůžko | | 1x na lůžko | |
| | | | | vypínač na rampě | | ode dveří | |
| Medicínální plyny - výbava na lůžko | | | | | | | |
| O2 | AIR 4 | N2O | VAC | CO2 | AIR 8 | AGSS | AirMotor |
| 2 | 1 | x | x | x | x | x | x |
| Silnoproudé a slaboproudé rozvody (počet zásuvek/počet obvodů) - výbava na lůžko | | | | | | | |
| MDO-bílá | ZIS-žlutá | VDO-oranž | DO-zelená | PA | sestra-pacient | | příprava pro slaboproud |
| 3/1 | x | x | x | 2 | příprava | | x |
| Příslušenství - výbava na lůžko | | | | | | | |
| Nosič 4 Infuzních sáčků | Police 400x400 | Držák monitoru vitálních fcí délky 200mm uchycený na medilištu | | Medilišta horní pozice nosnost 50 kg na mb | | Medilišta dolní pozice 600mm nosnost 50 kg na mb | |
| 1 | x | 1 | | po celé délce rampy | | 1 | |
| Projekt | | | | Název zařízení | | | |
| Úrazová chirurgie 4.NP | | | | Lůžková rampa | | | |