

Příloha č.8


Nemocnice Pardubice- Centrální urgentní příjem

4.NP- Operační sály

8a- Technická specifikace stropní stativ- 8x anesteziologický

Stropní otočně kyvný dvouramenný stativ –nosnost 180 kg

Ramena 1000 + 1000 mm, zdrojový sloup vysoký 1250 mm, zdvih do 20s 600mm

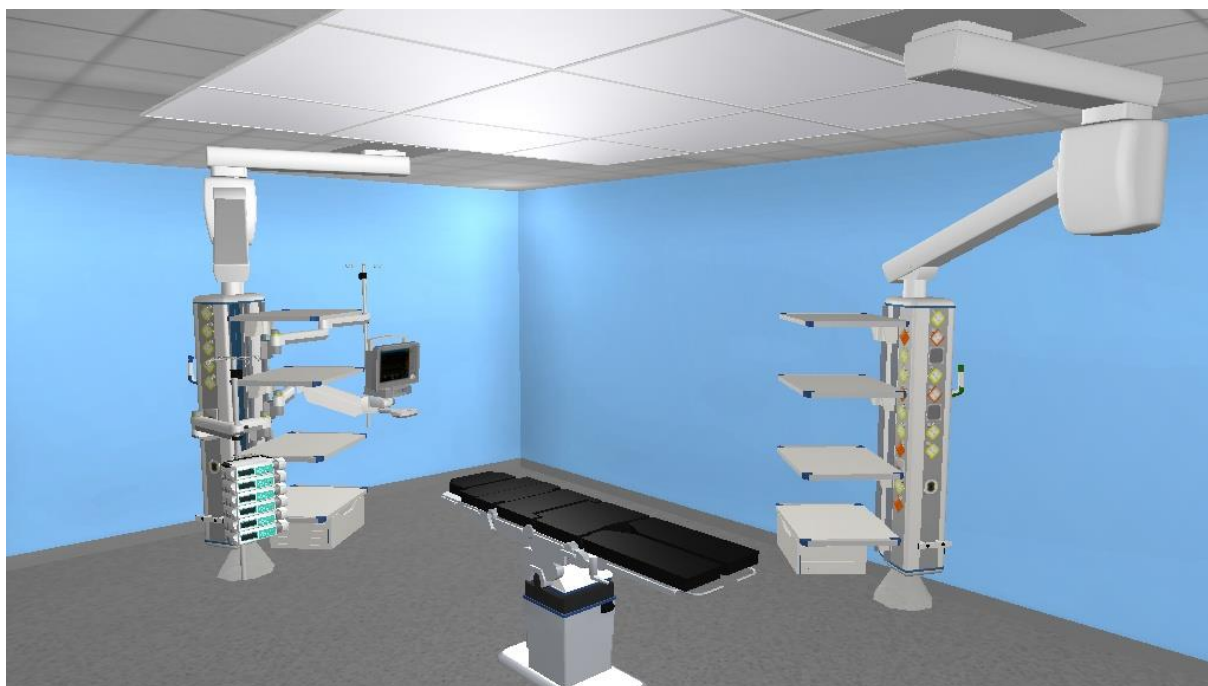

Výbava zdrojového sloupu:

Medicínální plyny: 2x O2, 2x AIR, 2x Vac, 2x N2O, 1x AGSS

Elektro: 19x zásuvka 230V s PA svorkou (6x VDO- oranžová, 13x ZIS- žlutá), 2x 2RJ45, 2x příprava slaboproudu pro budoucí instalace

Příslušenství zdr.sloupu:

4x police 530x480 mm s bočními medilištami- nosnost police 40kg

1x zásuvka pod spodní polici na příslušenství

1x ovládání brzd stativu na rukojetích (berany) umístěných v zadní části stativu

1x ramínko 500/300 mm se zdvihem + držák náhledového monitoru vitálních fcí

1x ramínko 400/400 mm pro nosič infuzní techniky

1x ramínko 400/400 mm pro nosič infuzních sáčků

1x lišta pro ukrytí přebytečných kabelů na pravé straně zdrojového sloupu (cable management)

1x integrované osvětlení ve spodní části sloupu stativu ovládané na sloupu

1x medilišta okolo hlavy stativu pro příslušenství

2x medilišta 180mm ve spodní části hlavy stativu pro odsávací sestavu

8b- Technická specifikace stropní stativ- 8x chirurgický

Stropní otočně kyvný dvouramenný stativ –nosnost 180 kg

Ramena 1000 + 1000 mm, zdrojový sloup vysoký 1250 mm, zdvih do 20s 600mm



Výbava zdrojového sloupu:

Medicínální plyny: 2x AIR, 2x SV8, 2x Vac, 2x CO2, 1x AGSS

Elektro: 20x zásuvka 230V s PA svorkou (6x VDO- oranžová, 14x ZIS- žlutá), 2x 2RJ45, 2x příprava slaboproudu pro budoucí instalace

Příslušenství zdr.sloupu:

4x police 530x480 mm s bočními medilištami- nosnost police 40kg

1x zásuvka pod spodní polici na příslušenství

1x ovládání brzd stativu na rukojetích (berany) umístěných v zadní části stativu

1x lišta pro ukrytí přebytečných kabelů na pravé straně zdrojového sloupu (cable management)

1x integrované osvětlení ve spodní části sloupu stativu ovládané na sloupu

1x medilišta okolo hlavy stativu pro příslušenství

2x medilišta 180mm ve spodní části hlavy stativu pro odsávací sestavu

m.č. 4147+4149 – korpus, ramena RAL 9002 + instalační lišty RAL 1023

m.č. 4145+4143, 4048+4046, 4051+4045 – korpus, ramena RAL 9002 + instalační lišty RAL 5023

m.č. 4135+4136 – korpus, ramena RAL 9002 + instalační lišty RAL 6011

m.č. 4132+4131 – korpus, ramena RAL 9002 + instalační lišty RAL 5021

m.č. 4140+4142 – korpus, ramena RAL 9002 + instalační lišty RAL 4001

m.č. 4138+4137 – korpus, ramena RAL 9002 + instalační lišty RAL 2011

neurčené místnosti – korpus, ramena RAL 9002 + instalační lišty RAL 7044